


当社への苦情につきましては、「QA-101 苦情処理基準書」「QA-119 不適合発生時の処理基準書」に基づき、下記の苦情処理プロセスにより対応および記録の保管をさせていただきます。

## 苦情処理プロセス

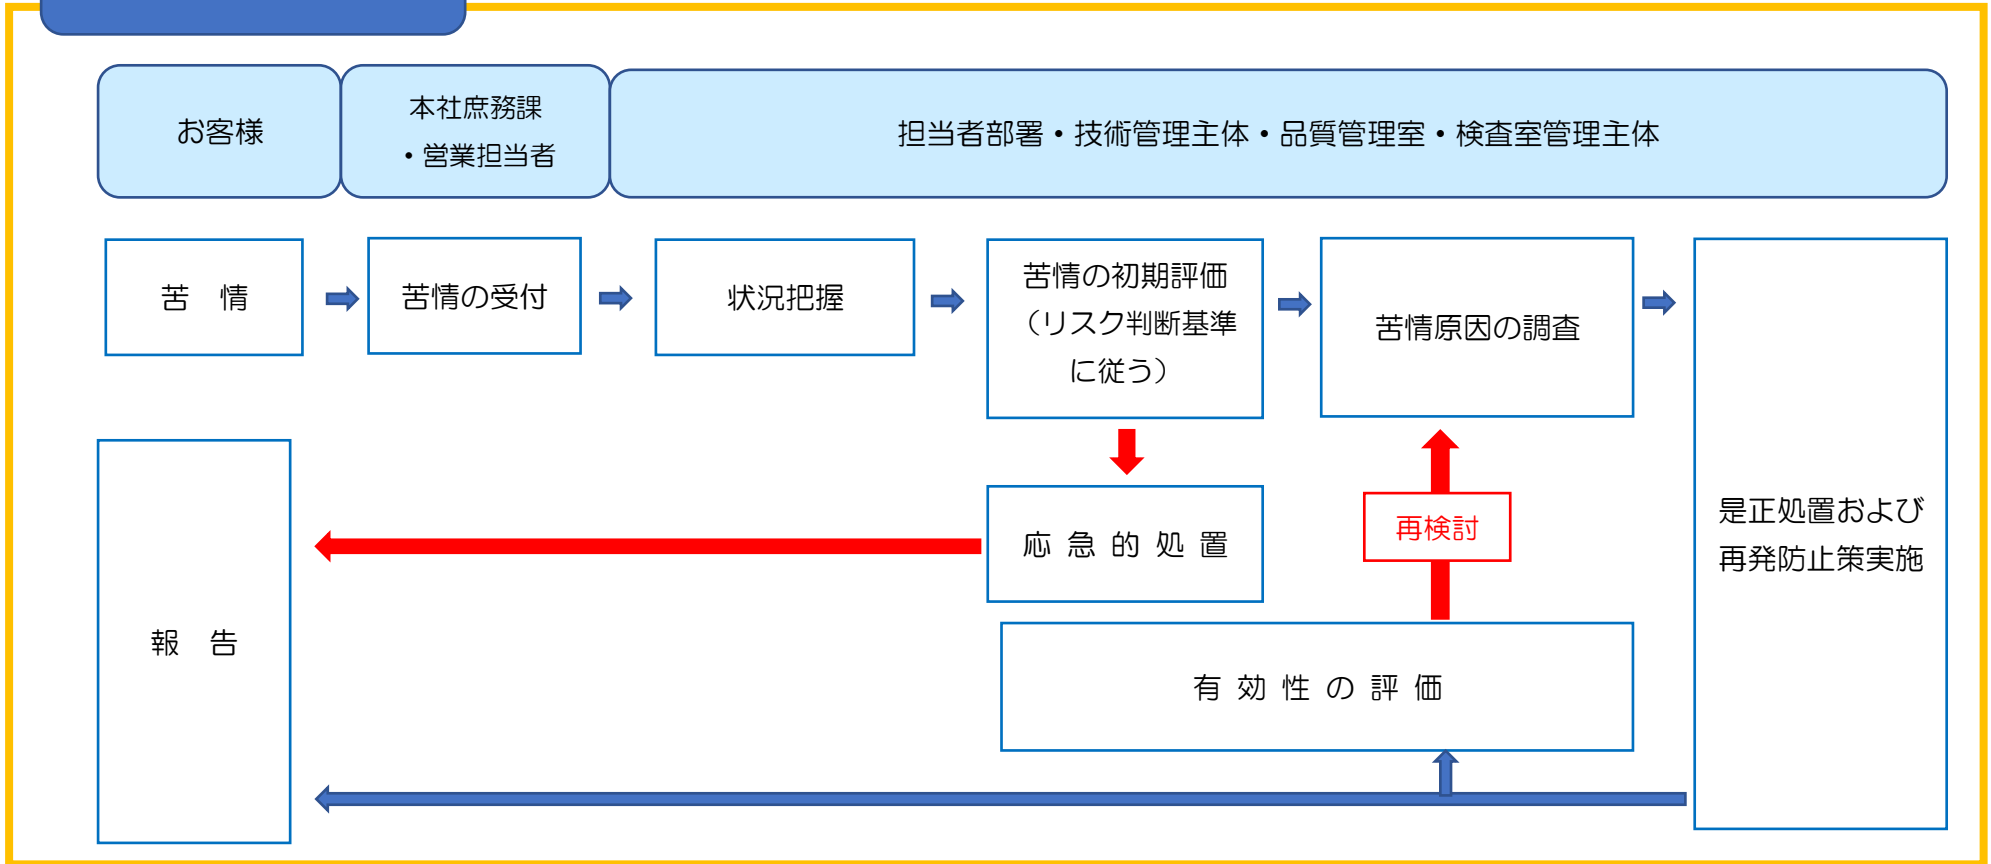

お問い合わせ先 株式会社 兵庫県臨床検査研究所 本社営業部 または最寄りの支所

本社 079-267-1251 神戸西支所 078-929-0492 神戸東支所 078-806-1560 岡山支所 086-952-5218 食品検査室 MEL079-267-1253 病理検査室 HPL079-268-1101